


Pression ajustable sur le crystal

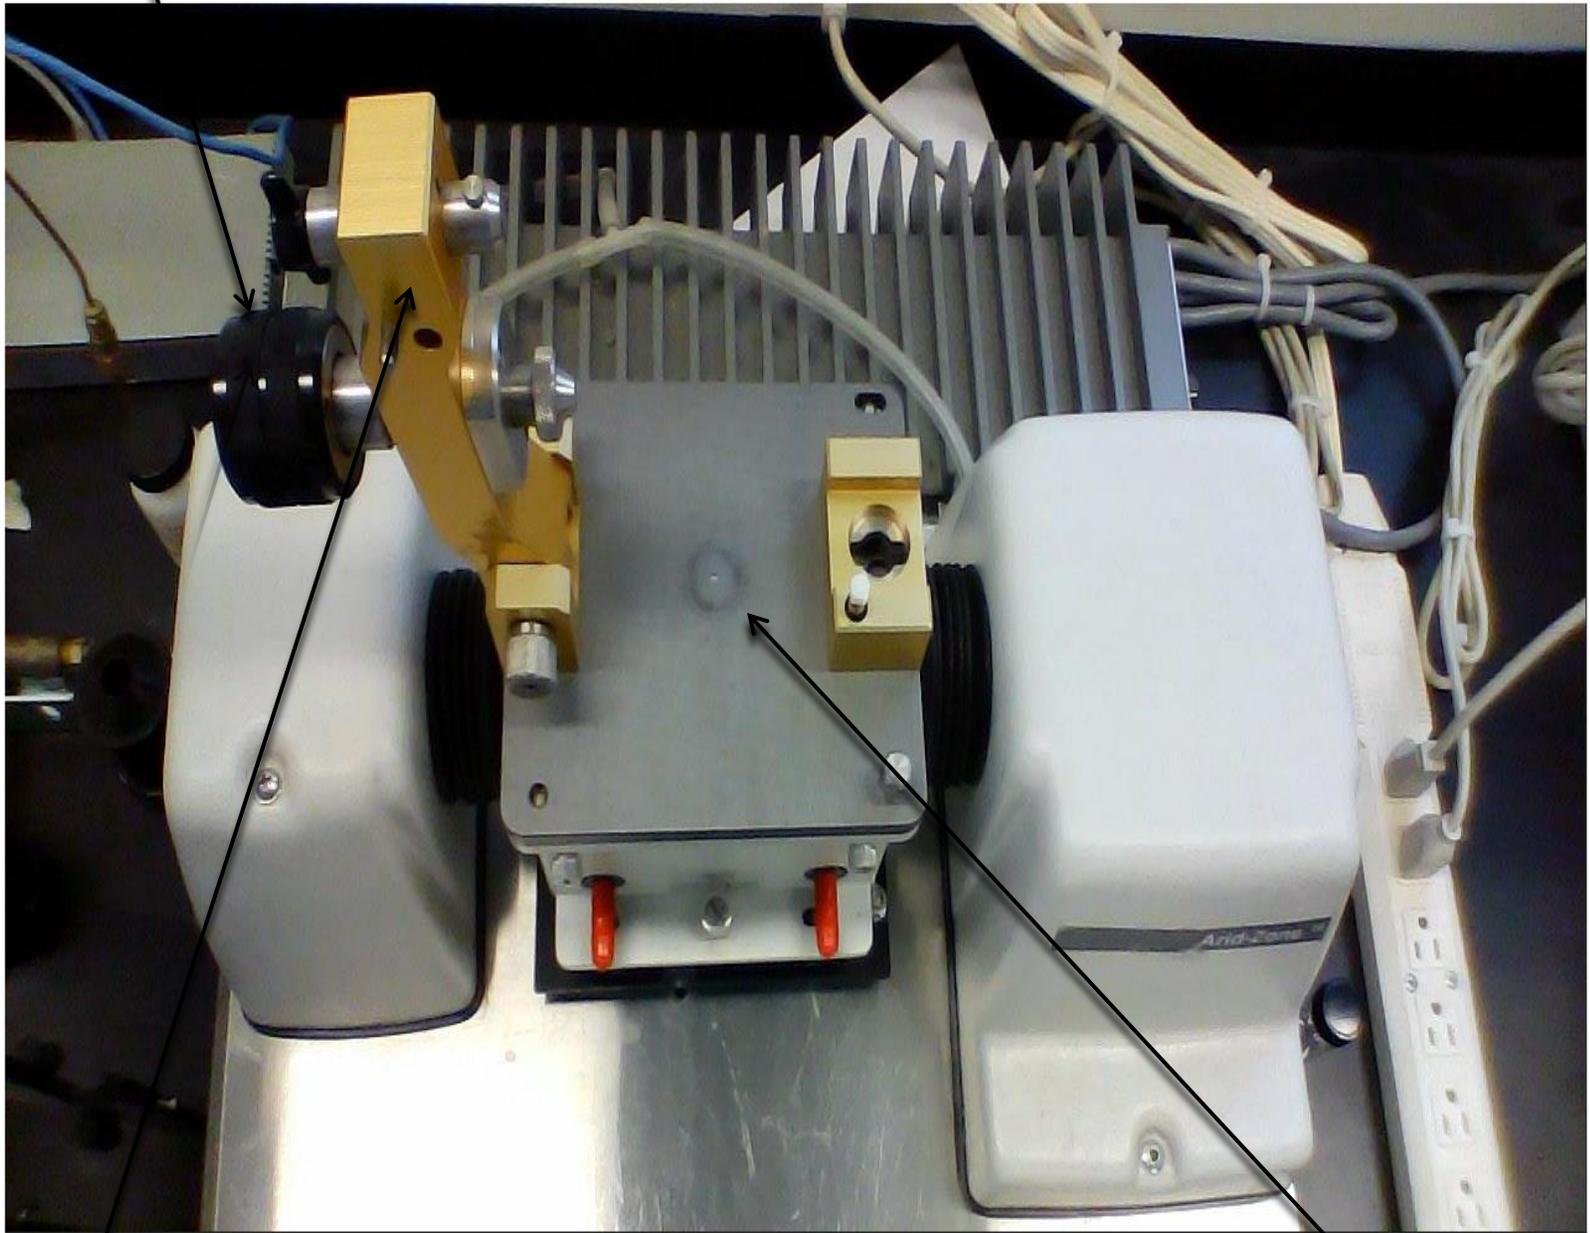

Bras de maintien du crystal

Emplacement du crystal pour analyse